



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

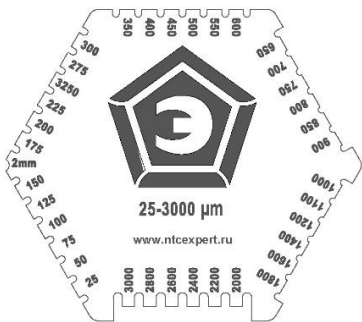
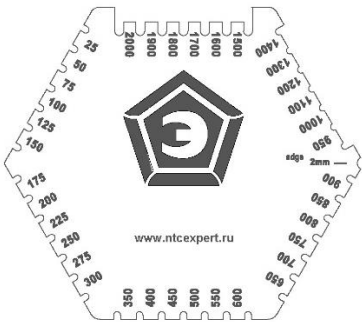
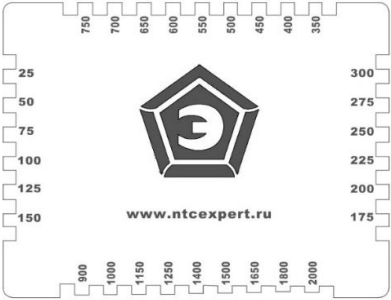
Толщиномер-гребенка серии ГЛК

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толщиномер-гребенка серии ГЛК (далее – гребенка, изделие) – предназначен для измерения неотвердевшего слоя лакокрасочных покрытий. Гребенка соответствует требованиям ГОСТ Р 51694-2000 (ИСО 2808-97). Подходит для работы специалистов занимающихся нанесением лакокрасочных и защитных покрытий различных объектов.

Конструктивно гребенки выполнены в виде прямоугольника или шестигранника с двумя опорными базами на каждой грани и рядом выступающих зубцов с нормированным зазором относительно базовой линии. Величина зазора отмечена на выступе.

Внешний вид изделий приведен в Таблице 1

ГЛК-1	ГЛК-2	ГЛК-3
		

Технические и метрологические характеристики изделий приведены в Таблице 2

Модель / параметр	ГЛК-1	ГЛК-2	ГЛК-3
Диапазон измерения, мкм	25 - 3 000	25 - 2 000	25 - 2 000
Шаг измерения, мкм	25 в диапазоне до 300 50 в диапазоне 300 – 900 100 в диапазоне более 900		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности шкалы, мкм (где Т – величина зазора)	$\pm(0,003 \cdot T + 4)$		$\pm(0,006 \cdot T + 4)$
Размеры, мм	64×74×1	74×85×1	60×80×1
Масса, г	50	50	50

2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

- протереть гребенку ветошью, смоченной в растворителе;
- прижать гребенку опорными гранями к окрашенной поверхности;
- определить толщину покрытия как величину между значениями толщины, на паре окрашенного и неокрашенного выступов (рис. 1).



Рисунок 1 – проведение измерений

3. СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие гребенки требованиям нормативно-технической документации при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- В процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы контактные поверхности не подвергались ударам, приводящим к образованию вмятин и царапин.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, поврежденные в результате небрежности или неправильного применения.
- Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- Полный средний срок службы - не менее 5 лет.

4. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Хранение гребенки должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150-69. Консервацию проводят по ГОСТ 9.014.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Толщиномер-гребенка ГЛК-1 / ГЛК-2 / ГЛК-3, заводской номер № _____ проверен и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20__ г.

Штамп отдела технического контроля _____ М.П.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Толщиномер-гребенка;
2. Паспорт изделия;
3. Чехол;
4. Сертификат калибровки по заявке.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель - ООО НТЦ «Эксперт»

127106 г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, строение 4, этаж 5, офис 506

www.ntcexpert.ru; Тел: +7 (495) 972-88-55; E-mail: info@ntcexpert.ru